

招标文件

采购方式：公开招标

委托单位：广东省人民医院

项目编号：HX12370115YLZC

项目名称：GE LISPEED VCT+LISPEED+CT（两台）全保维修服务采购项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年一月

目 录

总 则.....	1
第一章 基本情况.....	4
第一节 投标邀请函.....	4
第二节 用户需求书.....	7
第三节 工作流程图.....	11
第二章 投标文件的编制.....	12
第三章 投标文件的递交.....	16
第四章 开标、评标及定标.....	17
第五章 质疑与投诉.....	28
第六章 附 件.....	29
【附 件 1】 投标文件封面格式.....	29
【附 件 2】 资格符合性审查导读表.....	30
【附 件 3】 详细评审导读表.....	31
【附 件 4】 投标函.....	32
【附 件 5】 投标人资格文件声明函.....	33
【附 件 5-1】 投标人基本情况说明.....	34
【附 件 6】 投标人法定代表人资格证明书.....	35
【附 件 7】 投标人法定代表人授权委托书.....	36
【附 件 8】 投标报价函.....	37
【附 件 9】 投标报价一览表.....	38
【附 件 9-1】 分项报价表.....	39
【附 件 10】 退保证金说明函.....	40
【附 件 11】 中标服务费承诺书.....	41
【附 件 12】 用户需求书响应表.....	42
【附 件 12-1】 设备配置清单.....	43
【附 件 12-2】 设备的详细参数及简要说明书.....	43
【附 件 13】 同类项目业绩情况一览表.....	44
【附 件 14】 服务方案.....	45
【附 件 15】 服务技术人员一览表.....	46
【附 件 16】 通用合同书格式.....	47

总 则

1. 说明

1.1 适用主要法律

本项目的采购人、投标人、采购代理机构及有关当事人均参照《中华人民共和国政府采购法》及财政部和地方有关法律、法规。

1.2 招标范围

GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目, 具体内容见本招标文件第一章第二节《用户需求书》。

1.3 资金来源

本项目资金为**自筹资金**。

2. 定义及解释

2.1 采购人: 广东省人民医院。

2.2 采购代理机构: 广东华鑫招标采购有限公司。

2.3 投标人: 响应本次招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

2.4 货物: 投标人按招标文件规定, 向买方提供的货物、产品、工具等。

2.5 服务: 投标人按招标文件规定, 必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

2.6 评标委员会: 依法组建专门负责本次项目评标工作的临时性组织。

2.7 实质性响应: 是指符合招标文件的所有要求、条款等, 且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的货物和质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。

2.8 书面形式: 以文字形成书面文件的方式所制作的通知(包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式)。

2.9 投标保证金: 指投标人按照本招标文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时, 采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

3. 合格的货物和服务

3.1 投标人提供的所有货物和服务, 其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

3.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务, 由此产生的费用及相关后

果均由投标人自行承担。

3.3 投标人应承诺本项目下提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等; 如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用, 并在投标文件中附有相关证明文件; 如因第三方提出侵权诉讼, 则一切法律责任由投标人承担。

4. 纪律与保密事项

4.1 投标人不得串通作弊, 或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人, 扰乱招标市场, 破坏公平竞争原则。

4.2 获得本招标文件的投标人, 应对招标文件进行保密, 不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求, 开标后, 投标人应归还招标文件中的保密资料并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5. 承诺

投标人应承诺所提交的资料和数据是真实有效的, 否则所引发的责任由投标人自行承担。

6. 投标费用

投标人应承担本次项目的相关费用, 采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 投标人对招标文件如有疑问, 应以书面形式在投标截止时间 15 日之前通知到采购代理机构, 采购代理机构将以书面形式予以答复, 同时将书面答复发给已购买招标文件的每一投标人 (答复中不包括问题的来源)。

7.2 在投标截止时间 15 日以前, 无论出于何种原因, 采购人、采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清和修改, 并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人并且在相关网站上公告, 投标人在收到澄清和修改文件后, 应以书面形式向采购代理机构确认, 如 24 小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

8. 投标人的禁止事项

8.1 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外, 从开标之时起至授予合同

止, 投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

第一章 基本情况

第一节 投标邀请函

广东华鑫招标采购有限公司(以下简称“采购代理机构”)受广东省人民医院(以下简称“采购人”)的委托,就 GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目(项目编号: HX12370115YLZC) 进行国内公开招标, 欢迎符合资格条件的供应商参加投标。现将本项目招标文件进行公示, 公示期为 2016 年 2 月 1 日至 2016 年 2 月 5 日五个工作日, 相关事项如下:

一、采购项目的内容、数量

1. 采购内容

包号	包组内容	类别	预算金额
包一	GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修	服务类	420 万

2. 投标人须对本项目的服务进行整体响应, 任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

3. 采购项目具体要求: 详见招标文件《用户需求书》。

4. 服务地点: 采购人指定地点。

5. 不接受联合体投标。

二、投标人资格要求

1. 投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

2. 投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织, 具有《营业执照》、《税务登记证》。

3. 《公平竞争承诺书》原件和当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。

4. 项目必须投标人自行完成, 不进行转包或分包。

5. 本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1. 获取招标文件的时间: 2016年2月1日至2016年2月23日9:00~12:00, 14:00~17:00 (节假日除外)。
2. 获取招标文件的地点: 广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆3号楼1楼大堂
3. 获取招标文件要求:
符合资格的投标人应携带以下加盖单位公章的资料至采购代理机构报名:
(1) 有效的营业执照、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件。
(2) 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书。
(3) 《公平竞争承诺书》原件和当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。
4. 招标文件售价: 人民币 300 元整/套 (售后不退)。

四、已购买招标文件, 而不参加投标的供应商, 请于投标截止前以书面形式告知采购代理机构。

五、招标文件质疑

参照《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定, 供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的, 可以在公示期间或公示期后七个工作日内以书面形式 (加盖投标人公章) 向采购代理机构提交质疑书原件, 逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑, 质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。本招标项目不举行集中答疑会。

六、发布网站

本次招标项目公告等相关信息在相关法定媒体【中国政府采购网 (www.cccp.gov.cn)、广东华鑫招标采购有限公司网 (www.huaxinbidding.cn)】上公布, 并视为有效送达, 不再另行通知, 可下载招标文件电子版。

七、投标文件的递交

1. 递交投标文件时间: 2016年2月24日9:00 -9:30 (北京时间) 前。
2. 投标截止时间及开标时间: 2016年2月24日9:30 (北京时间), 逾期不予受理。
3. 递交投标文件及开标地点: 广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆3号楼3楼。

八、联系方式

采购人名称: 广东省人民医院

采购人地址: 广州市中山二路106号

采购代理机构名称: 广东华鑫招标采购有限公司

地 址: 广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆3号楼3楼

联 系 人: 葛小姐 联系电话: 020-87303028;

保证金专线: 020-87301313 (陈小姐)

传 真: 020-87302980

E-mail: cs@gdhuaxin.cn

九、标书款账户

开户银行: 农业银行广州明月路支行

收 款 人: 广东华鑫招标采购有限公司

账 号: 44032801040011101

广东华鑫招标采购有限公司

二〇一六年一月

第二节 用户需求书

技术规格、参数及要求

广东省人民医院 CT 保修服务要求	
序号	服务要求
▲1	投标人须具有独立法人资格
2	投标人在省内设有一个、邻省不少于 4 个稳定的常驻服务机构
2.1	投标人在广东省内需配备全职专业 CT 工程师≥5 名, 最少 2 名在 GE 公司连续服务年限>10 年, 并能提供劳动合同和企业为相应员工缴纳社保的证明。
2.2	投标人有 CT 全国专职技术支持团队≥5 人, 平均大于 10 年的 GE 公司连续服务年限, 提供名单。
2.3	全国维修人员: 成交人必须在全国有>20 名具备原厂认证同机型维修资质证的人员
2.4	以上维修人员需同时持有 GE 授权年度有效《维修资质证》(符合技术更新、考核合格的要求)
2.5	能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术、物力支持
▲3	投标人须具有独立完成标的中医疗设备维修、保养、安装的资格和能力(即在营业执照中有注册)
3.1	营业执照须经年检有效
3.2	经营范围必须包含报价项目
3.3	项目必须投标人自行完成, 不进行转包或分包
4	投标人企业通过 ISO9001 和 ISO13485、ISO27001 认证
4.1	投标人企业通过 TUV 或 BSI 或法国/德国相同水平公司审核的 ISO 认证
5	投标人注册资金必须大于人民币 200 万元
6	投标人须具有 GE CT 专业维修工具和 Tube 专业工具、仪器、合法的设备维修密钥, 并提供合法机构校正证明、工具序列号以供核实。
6.1	CT 高压检测工具 (HV Bleeder Package) ≥1 套
6.2	DAS/Dector 专用工具集 ≥1 套
6.3	力矩扳手/千分表 ≥1 套, 有权威检测部门的相关专业校准合格证书供核实
▲7	成交人必须保证设备开机率达到 95% 以上

8	投标人必须提供全部服务类型: 定期巡检、远程服务(电话支持、宽带远程支持、宽带远程交互保障)、现场服务
8.1	具备远程遥控诊断系统(inside)
8.2	能通过远程系统进行设备的维护, 并提供设备运行状况和措施报告
8.3	能通过远程系统 24 小时不间断监测设备运行健康状况(包括但不限于温湿度等等)、提供预警、主动预防型维护和维修方案, 须提供案例证据
9	投标人必须具备近 2 年国内与此招标同一机型系列新签保修合同 ≥ 3 个。
10	成交人必须具备 800 及 400 客户服务专线电话
10.1	每年 365 天开通, 并有 10 人以上专人接听, 且采用跨国公司提供的服务数据管理系统。
10.2	每天开通服务时间不少于 12 小时
▲11	响应时间要求: 成交人必须接获报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施;
11.1	每年响应时间为 365 天
11.2	响应时间须 ≤ 24 小时
11.3	到达现场时间 ≤ 48 小时
12	成交人必需能及时获取并提供全套原厂系统软硬件改版措施 (FA)
13	成交人必需能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙 (Service Key);
14	零备件供应: 所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件, 有追踪号码; 探测器、合法匹配测试的球管、IG 等关键部件, 必须能提供相应的合法进口报关证明
15	成交人必需在国内设有专门的设备零备件仓库, 且符合以下要求:
15.1	仓库面积须 > 2000 平方米
15.2	库存零件价值 $>$ 人民币 5000 万元
15.3	库存零件数量 > 5000 个
15.4	以上能提供合法证明
▲16	每年提供设备保养 ≥ 4 次, 使之保持原厂 QC 标准或国家质量计监部门之标准, 并包含如下项目:
16.1	机器清洁 ≥ 4 次/年
16.2	性能测试及校准 ≥ 4 次/年

16.3	必要的机械或电气环境的检查 \geq 4次/年
16.4	提供计划性的定期维护报告 \geq 4次/年, 且经原厂资深专家审核合格。
17	能提供电磁干扰与震动环境检测
18	能提供电源地线温度湿度质量检测
19	免费提供CT配套AW工作站的所有备件更换
20	合同启动时间为2015.12.01, 保修期: 3年

技术规格要求 (VCT 8M球管):


项目	招标要求	应标参数	偏离
1. ★	提供投标型号球管的原版技术白皮书 (DATA SHEET), 且以下应标参数均以此技术白皮书为准		
2.	阳极热容量: 8.0 MHU		
3.	焦点数量: \geq 两个		
4.	焦点尺寸 (IEC 336/1993): 小焦点 \leq 0.7mm*0.6mm; 大焦点 \geq 0.9mm*0.9mm		
5. ★	焦点功率要求最大 \geq 100KW, 且无时间限制		
6.	提供以 DATASHEET (技术白皮书) 为准的单层扫描 mA 输出参数 (120KV 时)		
7. ★	120KV, 5 秒单层扫描时, 球管最大电流输出 \geq 750mA		
8. ★	提供以 DATASHEET (技术白皮书) 为准的 VCT 多层扫描时毫安输出参数 (120KV 时)		
9. ★	120KV, 5 秒多层扫描时, 球管最大电流输出 \geq 750mA		
10.	球管最大电压 \geq 140KV		
11.	阳极靶面角度: 7 度		
12.	持续散热能力 \geq 648KHU/MIN		
13. ★	最大阳极散热能力 $>$ 2100KHU/MIN		
14.	功率 \geq 100KW		

技术规格要求 (6.3M 球管):

项目	招标要求	应标参数	备注
15. ★	提供投标型号球管的原版技术白皮书 (DATA SHEET), 且以下应标参数均以此技术白皮书为准		
16.	阳极热容量: 6.3 MHU		
17.	焦点数量: \geq 两个		
18.	焦点尺寸 (IEC 336/1993): 小焦点 \leq 0.7mm*0.6mm; 大焦点 \geq 0.9mm*0.9mm		
19. ★	焦点功率要求最大 \geq 53.2KW @ 20s		
20.	球管最大额定电压 \geq 140KV		
21. ★	球管最大耐受电压 \geq 180KV		
22.	阳极靶面角度: 7 度		
23. ★	球管采用金属陶瓷外壳材质		
24. ★	最小阳极转速: 8400RPM (以 DATASHEET 技术白皮书为准)		
25. ★	功率 \geq 53.2KW		

- 【备注】 1. 带★号条款为必须满足项, 任何负偏离将导致废标。
2. 带▲号条款为重点评审技术参数, 不作为无效投标条款。

第三节 工作流程图

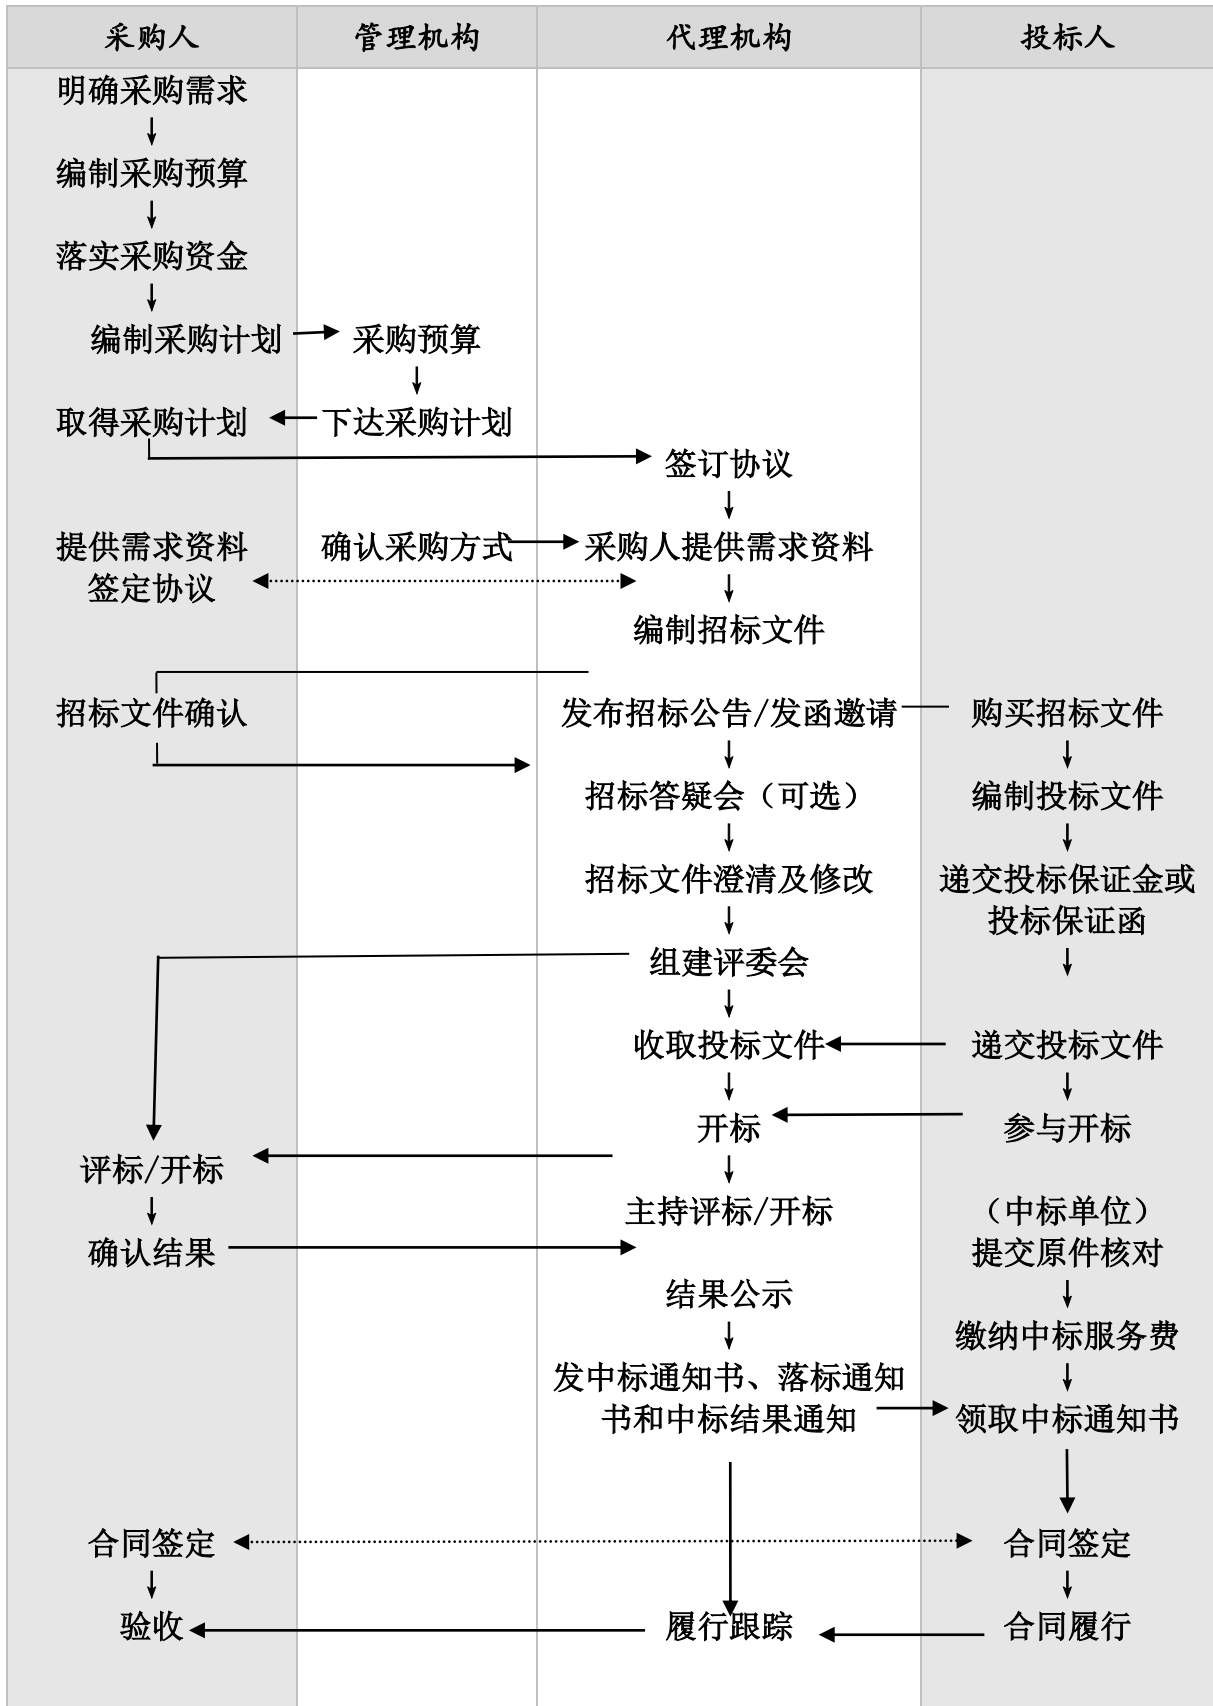

第二章 投标文件的编制

1. 投标语言及计量单位

1.1 投标人提交的投标文件、采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以是英文,但相应内容应附有中文简体翻译本,在解释时以中文简体翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。

1.2 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

2. 投标文件的组成

2.1 投标人的投标文件应按本招标文件**第六章附件**格式编写,至少包括以下部分:

- (1) 投标文件目录表
- (2) 投标人应提交的资格符合性审查资料
- (3) 投标报价资料
- (4) 投标人应提交的技术部分资料
- (5) 投标人应提交的商务部分资料

2.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件规定及要求的内容和格式编写投标文件。**投标文件必须实质性响应招标文件。**

3. 投标文件的签署和式样

3.1 投标人投标时提交的全部材料都必须密封,具体包括:

- (1) 投标文件一式 8 份 (正本 1 份,副本 7 份,其中正本密封件为一个独立包装件);
- (2) 投标报价函 (开标会上使用,须单独密封,详见【附件 8】);
- (3) 投标文件的电子文档 1 份 (以 U 盘或刻录光盘形式与投标文件正本一起密封提交)。

3.2 投标文件的正本按招标文件中已明示需要盖章签名处,均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章;投标文件的任何修改,必须有投标文件签字人在修改处签名及加盖公章才生效,其修改必须清晰。

3.3 投标文件每页应有页码 (插页除外),除要有明显的目录外,还要有《资格符合性审查导读表》、《详细评审导读表》 (详见【附件 2】、【附件 3】),且

导读表应置于目录之前。

3.4 投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致, 如果正本与副本或电子文档不符, 以正本为准。每份投标文件应在封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本可以是正本的复印本。

3.5 电报、电话、电子邮件、传真形式的投标文件概不接受。

4. 投标报价说明

4.1 投标人应按本招标文件第六章附件要求填写投标报价文件。

4.2 投标人如对多个包组进行投标, 每个包组只允许唯一固定报价, 且在合同执行期间是固定不变的, 不得以任何理由予以修改。对投标报价具有选择性的投标文件将视为非响应性投标予以拒绝。

4.3 投标报价应包含产品(含相关配件、附件、安装材料)价款、运输费、装卸费、安装费、保险费、税费以及一切技术和售后服务费等费用; 如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的, 还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费, 投标人不得再向采购人收取任何费用。

4.4 投标人漏报的费用, 视为此项费用已隐含在投标报价中, 中标后不得再向采购人收取任何费用。

4.5 投标人应以人民币为单位填报所有报价, 合同实施时亦以人民币支付。当单价与数量的乘积与总价不一致时, 以单价汇总为准并修正总价【单价的小数点有明显错误除外】。

5. 合格投标人的证明文件

5.1 投标人应提交其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件, 以及提供合同项下的货物和服务符合招标文件规定的证明文件, 并作为其投标文件的一部分。

5.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件, 可以是文字资料、图纸, 包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应, 应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时, 无论这种偏离是否有利于买方, 投标人都应按第六章附件格式如实填写《用户需求书响应表》。

6. 投标保证金

6.1 交《投标担保函》视为贵公司已履行了缴纳投标保证金的义务。(已提交

保证金的可无需再提交《投标担保函》)

6.2 投标保证金必须以银行划账提交或自愿选择以投标担保函的形式交纳投标保证金, 应符合下列规定:

6.2.1 投标保证金以银行划账形式提交的:

6.2.2 收款人: 广东华鑫招标采购有限公司

开户银行: 广发银行广州市海月路支行

账 号: 130003516010006810

6.2.3 投标保证金如下表:

包号	包组内容	保证金金额(人民币/元)
包一	GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务	42000

6.2.4 **投标保证金应在投标截止时间前到达招标采购代理机构账户, 开标会现场不接受任何形式的投标保证金。(重要提示: 由于转账当天不一定能够到账, 建议至少提前两个工作日转账。)**

6.3 投标人填写银行交款票据时, 必须清晰填写投标单位全称、投标单位开户银行及账号、项目编号, 并对所填写资料的真实性和准确性负责, 且与《退保证金说明函》的收款单位名称、开户银行和账号一致。否则, 有可能造成保证金退还的延误。

6.4 **保证金转账底单请传真至招标采购代理机构(020-87302980), 并注明项目编号及所投包号及包组内容。**

投标保证金用于保护采购人和招标采购代理机构免受因投标人的行为而引起的风险。采购人或招标采购代理机构在因投标人的行为而受到损害时, 将依法没收其投标保证金。

6.5 未按规定提交投标保证金的投标, 将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.6 投标保证金退还, 按如下有关规定执行:

(1) 未中标人的投标保证金, 在发出《中标通知书》后无息退还。

(2) 中标人的投标保证金在采购合同签订后凭**采购合同(原件)**到招标采购代理机构办理无息退还手续。

(3) 在投标有效期内不能确定中标人的, 在投标有效期满后五个工作日内退回

所有投标人的投标保证金。

(4) 如有质疑或投诉,将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

6.7 有下列情况之一的,投标人的投标保证金将会被没收:

- (1) 投标人在参与招标活动期间,违反有关法律法规规定的;
- (2) 投标人在收到《中标通知书》后,未在招标文件规定期限内签订采购合同的【有特殊情况除外】;
- (3) 投标人在投标截止时间后,在投标有效期内撤回其投标的;
- (4) 投标人在中标后未按招标文件规定缴纳中标服务费的;
- (5) 中标人将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未明确,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的。

7. 投标有效期

7.1 投标文件应在投标截止日后的 90 日内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

7.2 在特殊情况下,原有投标有效期截止日之前,采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收;接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件,而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下,投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

第三章 投标文件的递交

1. 投标文件的密封和标记

1.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开用两个封套装好并密封,且在封套上标明“正本”“副本”及投标人名称、地址及联系方式,封套的封口处须加盖投标人公章。

1.2 包装封套均应注明:

“收件人: 广东华鑫招标采购有限公司

项目名称: GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目

项目编号: HX12370115YLZC

包 号: _____

于北京时间 2016年2月24日9:30 之前不得启封” 的字样。

1.3 投标人递交投标文件时需单独提交一份“**投标报价函**”,详见【附件8】。

1.4 采购代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

1.5 如果封套未按本招标文件的要求密封和加写标记,对于误投或过早启封的,采购代理机构概不负责。

2. 投标截止时间

2.1 投标截止时间: 2016年2月24日9:30 (北京时间)

2.2 投标文件递交时间: 2016年2月24日9:00 -9:30 (北京时间) 前。

2.3 所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点,任何迟于投标截止时间的投标文件将被拒绝接收。

3. 投标文件的修改与撤回

3.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章,并作为投标文件的组成部分。

3.2 从投标截止时间至投标有效期期间,投标人不得撤回其投标,否则其投标保证金将按规定被没收。

第四章 开标、评标及定标

1. 取消招标活动的权利

采购人经过法定程序, 有权在授标之前任何时候取消本次招标活动, 对受影响的投标人不承担任何责任, 也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

2. 开标

2.1 本次招标采用一次开标形式, 按本招标文件《投标邀请函》规定的时间和地点进行开标。

2.2 采购代理机构组织和主持开标会, 所有投标人的法定代表人或其授权代表都务必准时参加开标会, 并按时签到。

2.3 开标大会由采购代理机构主持, 并邀请监督人、采购人代表参加。在投标截止时间后, 由监督人和投标人代表(投标人代表产生原则: 以签到时间为序, 按《投标人签到表》的第一家作为投标人代表。), 若无监督人或采购人代表到场, 则按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表在开标现场共同查验投标文件的密封情况, 确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封《投标报价函》进行唱标。唱标时, 采购代理机构当众将投标人名称、包组内容、投标价格以及采购代理机构认为需要唱标的内容(不涉及商业秘密的相关内容等)进行唱标, 现场记录人员做开标记录, 并打印出纸质文件给各投标人授权代表、唱标人、记录人、监督人及采购人代表签名确认(各投标人代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核, 如有异议应当场提出, 否则视为同意)。

2.4 法定投标截止时, 如投标人满足三家及以上的, 正常开标, 开标时均当众予以拆封、宣读。若不足三家的, 则停止开标, 并将投标文件原封退还给投标人, 当其中某包组投标人少于三家, 该包组将视为采购失败, 采购代理机构将依法重新组织招标采购。

2.5 任何迟交或撤回的投标文件将被原封退回投标人。

3. 评标委员会的组成

3.1 采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由7名成员组成, 除1名采购人指派评委外, 其余6名均由专家库中随机抽取产生。

3.2 评标委员会(不含采购人代表)有下列情形之一的, 受到邀请应主动提出回避, 采购当事人也可以要求该评审专家回避:

- (1) 三年内曾在参加该采购项目供应商中任职或担任顾问的;
- (2) 配偶或直系亲属在参加本项目的供应商中任职或担任顾问的;
- (3) 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的;
- (4) 评审委员会中, 同一任职单位评审专家超过二名的;
- (5) 评审专家所在单位与采购人或参与本项目供应商存在行政隶属关系的;
- (6) 曾参与本项目招标文件论证的;
- (7) 法律、法规规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

3.3 评标委员会将根据招标文件的规定对各投标文件进行评审, 得出评标结果, 向采购人提交评标报告并推荐中标候选人。

4. 评标原则、评标步骤和评标方法

4.1 评标基本原则:

- (1) 评标委员会按照规定对通过初步评审的投标文件进行详细评审。
- (2) 参照《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的相关规定, 遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则进行。

4.2 评标步骤: 评标过程分初步评审、详细评审两个阶段进行。通过初步评审的投标文件才能进入详细的评审, 详细评审分为技术评审、商务评审、价格评审, 且不保证最低投标报价中标。

4.3 评标方法: 本次招标采用综合评分法

内容	技术部分	商务部分	价格部分
权重	60%	20%	20%
分值	60分	20分	20分

根据各投标人的技术、商务、价格得分, 计算出各包投标人的综合得分, 评标委员会按各包综合得分由高到低的原则进行排序, 推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

5. 投标文件的更正和澄清

在评标过程中, 评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正由其授权代表签字, 并以书面形式提交。澄清或说明均不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6. 投标价格的核准

6.1 评标委员会对投标人报价进行复核, 看其是否有计算上的错误, 更正错误的原则如下:

(1) 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(2) 当单价和数量的乘积与总价不一致时, 以单价为准, 并更正总价; 但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3) 对于买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用, 如果投标人是另外单独报价的话, 评分时计入投标报价总价;

(4) 当投标人的报价出现漏项时, 评标委员会取所有投标人的此项最高报价作为漏项报价并更正总价, 计算价格得分; 【如获中标则视该投标人免费提供该项内容, 参照本文第二章 4.4】。

(5) 开标时, 投标报价函的《投标报价一览表》经唱标, 投标人授权代表签字确认后, 发现与投标文件正本的《投标报价一览表》不一致, 以投标报价函的《投标报价一览表》为准;

6.2 按上述 6.1 调整后的投标报价, 对投标人具有法律约束力。如果投标人不接受更正后的价格, 则被视为无效投标, 其投标保证金依法予以没收。

7. 初步评审

7.1 评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定, 对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查, 以确定投标人是否具备投标资格; 评标委员会依据招标文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应, 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容, 而不寻找其他外部的证据。【详见附表一《初步评审表》】。

7.2 在资格符合性审查时, 如出现下列情形之一的, 本次投标将确定为无效投标:

- (1) 投标人未提交投标保证金或金额不足;
- (2) 投标总金额超过本项目采购预算;
- (3) 投标报价不是固定唯一价;
- (4) 投标文件的制作不符合招标文件要求的;
- (5) 不具备招标文件中规定资格要求的;
- (6) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的;
- (7) 针对《招标文件》中的★号条款产生偏离的;

- (8) 符合招标文件规定的被视为无效投标的;
- (9) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录;
- (10) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

7.3 投标文件的澄清

评标期间, 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会可以采用书面形式(由评标委员会签字确认后)要求投标人做出必要的澄清及说明, 但不允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。【投标人的澄清及说明等应当采用书面形式, 由其授权代表签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。】

8. 详细评审

8.1 详细评审是对技术、商务和价格进行评审。

(1) 技术评审: 对招标文件中各项技术要求的响应程度、服务质量综合评价等因素进行评审和比较, 并量化打分。统计技术得分是取各评委的技术评分的算术平均值作为该投标人的技术得分。【详见附表二《技术评分表》】。

(2) 商务评审: 对招标文件中商务要求的响应程度、销售业绩、财务状况等因素进行评审和比较, 并量化打分。统计商务得分是取各评委的商务评分的算术平均值为该投标人的商务得分。【详见附表三《商务评分表》】。

(3) 价格得分: 价格得分采用《低价优先法》计算。【详见附表四《价格评分表》】。

8.2 综合得分由投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加, 计算得出各投标人的综合得分。

8.3 经评标委员会详细评审, 一致认为都不符合招标文件要求的, 可以否决所有投标。

9. 定标

9.1 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人, 排名第二的投标人为第二中标候选人, 以此类推。

- (1) 综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列;
- (2) 综合得分且投标报价相同的, 按技术部分得分由高到低顺序排列。

9.2 评标委员会提交评标报告和推荐中标候选人后, 在规定日期内经采购人确认后, 将在媒体上进行中标结果公示(与发布招标公告的媒体一致)。

(1) 不在中标名单之列者即为未中标供应商, 采购代理机构不再以其他方式另行通知。

(2) 采购代理机构以书面形式向中标人及采购人发出《中标通知书》。

9.3 中标人应出具《中标通知书》, 在依法规定时间内与采购人签订合同。

9.4 如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同, 或经核定中标人的投标文件与事实不符, 从而影响公平、公正及中标合同执行的, 采购人有权取消该中标人的中标资格, 确定排名第二的中标候选人为中标人。

9.5 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订政府采购合同, 或因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的, 采购人可以与排名第二的中标候选人签订合同。

9.6 在合同签订前, 采购人发现中标人的投标报价、供货范围有缺漏和存在重大偏差, 甚至存在欺诈行为时, 将有充分理由取消中标人资格, 没收其投标保证金, 并保留依法追究的权利。

9.7 在合同签订前, 如发现中标人存在弄虚作假等情况骗取中标的, 采购人有权取消其中标资格, 并将排名第二的中标候选人确定为中标人。

9.8 如果中标候选人均无法签订合同, 采购人将依法重新招标, 对受影响的各方不承担任何责任。

10. 《中标通知书》的发放

10.1 招标结果在相关网站上公示, 对招标结果在公示期间如供应商有质疑, 应以书面形式向采购代理机构递交正式的质疑文件(授权代表签字并加盖投标人公章才视为有效文件)。公示结束后, 如无质疑或质疑投诉已处理完毕, 由招标采购代理机构向投标人及采购人出具《中标通知书》《未中标通知书》。

10.2 《中标通知书》是合同的组成部分, 对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》一经发出, 采购人无故改变中标结果, 或中标人擅自放弃中标的, 须依法承担法律责任。

11. 中标服务费

11.1 在领取《中标通知书》前, 中标人须按规定及时向招标采购代理机构缴纳中标服务费, 该中标服务费按(发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号)文规定进行收取, 详情请在广东省物价局网上查询。

(1) 中标服务费不在投标报价中单列。

(2) 中标服务费以电汇、转账支票或现金的形式一次性支付。

12. 签订合同

12.1 中标人在收到《中标通知书》后, 应按照《中标通知书》指定的时间、地点, 派遣其授权代表前往与采购人或所指定的用户单位签署合同。

12.2 下列文件均为合同的组成部分:

- (1) 广东华鑫招标采购有限公司项目编号为 HX12370115YLZC 的招标文件。
- (2) 《中标通知书》。
- (3) 中标人的投标文件。
- (4) 与本次招标活动有关的书面澄清、修改及补充说明。

13. 保密事项

13.1 采购代理机构应采取必要的措施, 保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

13.2 公开开标后, 直至中标人与采购人签订合同为止, 凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容, 任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

13.3 从投标截止日起到定标日止, 投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中, 如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响, 其投标将被拒绝。

13.4 评标委员会成员在评标时应关闭通讯工具, 统一交由工作人员保管。

附表一 初步评审表

资格符合性审查内容	投标人 A	投标人 B	……
投标人资质满足招标文件要求			
投标文件的完整性			
投标保证金按招标文件要求提交			
投标有效期 90 日			
投标文件符合招标文件签署要求			
满足招标文件中的★条款			
投标报价是固定唯一价, 且不低于成本价			
投标报价未超出预算			
投标文件实质性响应招标文件要求, 半数以上评委认定为有效标的			
结论			

【备注】有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人, 不得进入下一步详细评审。

附表二 技术评分表 (60 分)

评审项目	评分标准	分值	投标人 A	投标人 B
根据投标人对招标文件标示“▲”的技术参数逐条响应情况进行评分。(20分)	完全响应招标文件的技术参数和性能要求的,得20分。每负偏离一项扣4分,最高扣至该项得0分。	0-20			
根据投标人对招标文件非标示“▲”的技术参数逐条响应情况进行评分。(10分)	完全响应招标文件的技术参数和性能要求的,得10分。每负偏离一项扣0.5分,最高扣至该项得0分。	0-10			
服务管理方案评价(5分)	服务管理方案覆盖用户所有要求,且具体、可行、全面综合评价为优	4-5			
	服务管理方案可行性一般,综合评价一般	2-3			
	服务管理方案基本满足采购需求,但存在负偏差,综合评价较差	0-1			
项目人员素质(20分)	①投标人有CT全国专业技术支持团队≥5人。 (5人得5分,每多1人多1分,最多7分;若不足5名则为0分) ②其中至少一名在GE公司连续服务年限>10年。(1分) 要求能提供劳动合同和企业为相应员工缴纳社保的证明	0-8			
	投标人在全国有>20名具备原厂认证同机型维修资质证的人员,得4分;若≤20名则为0分(必须能提供劳动合同和相应员工社保缴纳证明。)	0-4			
	以上维修人员需同时持有GE授权有效期《维修资质证》,能提供的每人0.5分,总分8分。(符合技术更新、考核合格的要求)	0-8			

评审项目	评分标准	分值	投标人 A	投标人 B
项目用检测工具 (3分)	CT 高压检测工具(HV Bleeder Package) 和 DAS/Dector 专用工具集, 提供序列号供核实。 每项工具都具有一个得 2 分, 一个以上得 3 分。本项总分 3 分。	0-3			
能够取得设备生产者或研发和工厂的技术、物力支持 (2分)	投标人获得有有效的制造商授权, 可以出具授权证明 (附复印件)。 有: 2 分 无: 0 分	0-2			
合 计	60 分				

【备注】 招标文件要求提交的各类有效资料, 投标人如未按要求提交的, 该项评分为零分。

附表三 商务评分表 (20分)

评审项目	评分标准	分值	投标人 A	投标人 B
财务情况 (2分)	提供 2013、2014 年度经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表, 横向对比, 财务状况良好	2			
	提供 2013、2014 年度经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表, 横向对比, 财务状况一般	1			
	证明资料欠缺或没法考证	0			
企业资质 (6分)	投标人企业通过 ISO9001 和 ISO13485、ISO27001 认证 (必须是投标人企业通过 TUV 或 BSI 或法国/德国相同水平公司审核的 ISO 认证) 每个认证 2 分, 总分 6 分。	0-6			
投标人库存零件情况 (6分)	仓库面积须>2000 平方米, 库存零件价值>人民币 5000 万元, 库存零件数量>5000 个, 以上要求每满足一个得分 2 分, 需提供相关明证, 总分 6 分	0-6			
投标人类似项目经验 (6分)	投标人在最近二年曾经承接过相类似项目, 等于 5 个得 5 分, 每多 1 个得 1 分; 少于 5 个 0 分。总分 6 分。(类似项目指同一机型系列新签保修维修, 以合同为准)	0-6			
合 计		20分			

【备注】招标文件要求提交的各类有效资料, 投标人如未按要求提交的, 该项评分为零分。

附表四 价格评分表 (20 分)

序号	投标人	投标报价 (人民币)	基准价 (人民币)	价格得分

【备注】 价格得分采用《低价优先法》计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为 20 分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times 20$$

第五章 质疑与投诉

1. 投标人有质疑时,必须以书面形式(法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章)在质疑有效期限内向采购代理机构交质疑书原件,逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则,质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容:具体的质疑事项、事实依据及相关的证明材料并注明该证明材料的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间,质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。招标采购代理机构受理书面质疑书原件之日起,在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上,将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

3. 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密。

4. 质疑联系方式

名称: 广东华鑫招标采购有限公司

地址: 广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆3号楼3楼

电话: 020-87303028

传真: 020-87302980

第六章 附件

【附件 1】 投标文件封面格式

正本/副本

投标文件

项目编号: HX12370115YLZC

项目名称: GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目

包号及内容 : _____

投标单位: _____

地 址: _____

联系人: _____

联系电话: _____

【附件 2】 资格符合性审查导读表

资格符合性审查导读表

资格符合性 审查内容	招标文件要求	提供情况		页码 范围	备注
		有	无		
投标函、投标人资格文件声明	按附件 4、附件 5 文件格式编制、签署、盖章(原件)				
投标人资格条件	按招标文件第一章 第一节 投标邀请函二、投标人资格要求 提供证明资料				
投标人法定代表人资格证明书、投标人法定代表人授权委托书	按附件 6、附件 7 文件格式编制、签署、盖章(原件)				
投标保证金	人民币___元整(¥ 元) (提供交纳凭证的复印件并加盖公章)				
投标有效期	投标截止日后 90 日内有效				
带“★”条款	必须满足				
投标报价要求	报价方案是唯一确定,未超出预算,且不低于成本价				
投标文件制作要求	投标文件完整且符合招标文件签署要求				

【备注】 以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容,投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供,对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标!在对应的□打“√”。

投标人法定代表人(或授权代表)签字: _____

投标人名称(签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件3】 详细评审导读表

详细评审导读表

文件类型	序号	文件名称	提供情况		页码范围	备注
			有	无		
投标报价部分 (加盖投标人公章)	1	投标报价一览表(附件9)				
	2	分项报价表(附件9-1)				
技术部分 (加盖投标人公章)	1	用户需求书响应表(附件12)				
	2	按照技术评分表中“评分项目”逐一列明(本表格可加行)				
	3	根据招标文件,投标人认为有需要提供的其它技术资料				
商务部分 (加盖投标人公章)	1	按照商务评分表中“评分项目”逐一列明(本表格可加行)				
	2	根据招标文件,投标人认为有需要提供的其它商务资料				

【附件4】 投标函

投 标 函

致: 广东华鑫招标采购有限公司

依据贵方GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目 (项目编号: HX12370115YLZC) 招标采购货物及服务的投标邀请, 我方代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表 (投标人名称、地址) 提交投标文件正本__份, 副本__份。

在此, 我方声明如下:

1. 我方已经全面仔细地阅读了招标文件及其附件【包括澄清及参考文件】, 同意接受及遵守招标文件的各项要求和规定, 并按照其要求提供报价。

2. 投标有效期为递交投标文件之日起 90 天, 中标人投标有效期延至合同验收之日。

3. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件, 无论是原件还是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假、伪造和夸大的成份, 否则, 愿承担相应的后果和法律责任。

5. 我方完全尊重和认可评委会所作的评标结果。【同时, 理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格】。

6. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

7. 联系方式:

地 址: _____

传 真: _____

电 话: _____

开户银行: _____

账 号: _____

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【备注】 本《投标函》内容不得擅自删改。

【附件5】 投标人资格文件声明函

投标人资格文件声明函

致: 广东华鑫招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称: GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目 (项目编号: HX12370115YLZC) 投标邀请, 本签字人愿意参加投标响应, 提供招标文件中规定的货物及服务, 并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1.
- 2.
- 3.
-

(相关证明文件附后)

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 5-1】 投标人基本情况说明**投标人基本情况说明**

一、公司基本情况

1、公司名称: _____ 电话号码: _____

2、地 址: _____ 传 真: _____

3、注册资金: _____ 经济性质: _____

4、公司开户银行名称及账号: _____

5、营业注册执照号: _____

6、公司简介

7、公司财务情况:

年份	年营业总值	净利润	资产负债率	经营活动产生的现金流量净

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明:(如有)

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

【备注】 以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

我方声明以上所述是正确无误的, 贵方有权进行认为必要的调查。

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部应有的资料和数据, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人法定代表人(或授权代表)签字: _____

投标人名称(签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件6】 投标人法定代表人资格证明书

投标人法定代表人资格证明书

致: 广东华鑫招标采购有限公司


_____同志, 现任我单位_____职务, 为法定代表人, 特此证明。

签发日期: _____ 单位: _____ (盖章)

附:

身份证号码:	联系电话:
代表人性别:	年龄:
营业执照号码:	经济性质:
主营(产):	兼营(产):
进口物品经营许可证号码:	
主营:	兼营:

- 【说明】**
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 2. 所填内容必须真实、清楚, 不得涂改。
 3. 为避免废标, 请投标人务必提供本附件

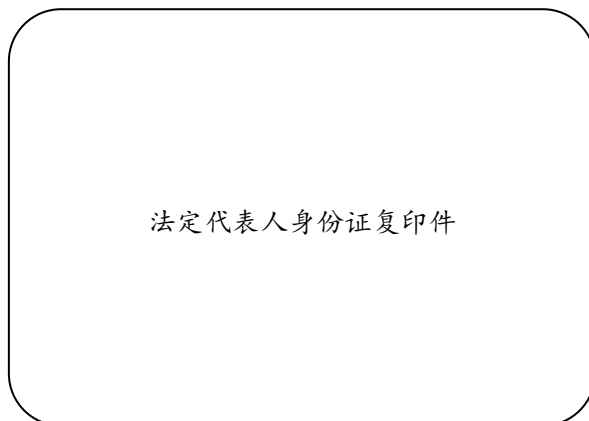

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 7】 投标人法定代表人授权委托书

投标人法定代表人授权委托书

致: 广东华鑫招标采购有限公司

兹授权_____同志, 为我方签订经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是: 全权代表我司参与本项目的投标响应, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位: _____ (盖章) 法定代表人: _____ (签名或盖私章)

有效期限: 至____年__月__日 签发日期: ____年__月__日

附:

身份证号码:	联系电话:
代表人性别:	年龄:
营业执照号码:	经济性质:
主营 (产):	兼营 (产):
进口物品经营许可证号码:	
主营:	兼营:

- 【说明】**
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 2. 所填内容必须填写真实、清楚, 不得涂改。
 3. 有效期限: 与本公司投标文件中标注的投标有效期相同, 自本单位递交投标文件之日起生效。
 4. 投标签字代表为法定代表人, 则本附件不需提交。

授权代表身份证复印件

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: ____年__月__日

【附件8】 投标报价函

投标报价函

内装:

1. 《投标报价一览表》原件 (详见附件9);
2. 《退保证金说明函》原件 (详见附件10) 【仅作退保证金时用】;
3. 保证金转账底单复印件加盖投标人公章。

【说明】 本“投标报价函”需单独密封提交。

【附件9】 投标报价一览表**投标报价一览表**项目名称: GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目项目编号: HX12370115YLZC

投标价格单位: 人民币/元

包号	包组内容	投标总价	备注
包一	GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务	小写:	
		大写:	

- 【说明】** 1. 此表的投标价格包括零部件价格、运输、安装调试、验收、培训、技术服务等一切费用。
2. 此表除装订于投标文件中外, 还应将此表原件一份置于投标报价函中。

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 9-1】 分项报价表**分项报价表**项目名称: GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目项目编号: HX12370115YLZC

【价格单位: (人民币) 元】

序号	项目名称、内容	单价	数量	总价 (金额)
1				
2				
3				
4				
...				
...				
总计:				

- 【说明】**
1. 此表为《投标报价一览表》的报价明细表。
 2. 如果单价和总价不符时, 以单价汇总为准, 更正总价(这里所指的总价, 以《投标报价一览表》为准)。
 3. 投标人应列明《用户需求书》所要求提供的全部货物的价格明细, 包括备品备件及专用工具。
 4. 投标人应列明《用户需求书》所要求提供的相关服务的价格明细, 包括零配件费用、人员工资、人员福利、社保、税费、管理费用、利润等一切支出。

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 10】 退保证金说明函

退保证金说明函

致: 广东华鑫招标采购有限公司

我方为 GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目 (项目编号: HX12370115YLZC) 包____ 投标所提交的投标保证金人民币_____元, 请贵司退还时转账至以下账户:

收款单位: _____

开户银行: _____

账 号: _____

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年 ____月 ____日

【备注】★投标人提供的退还保证金账户必须与实际投标人名称一致, 此函要求盖公章。

保证金银行汇款回单粘贴处

(需加盖公司公章)

【附件 11】 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致: 广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的 GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目 (项目编号: HX12370115YLZC) 招标中我方如获中标, 我方保证在收到《缴费通知书》后, 按要求及时向贵公司缴纳中标服务费。

如我方违约, 愿接受贵公司出具的违约通知, 按中标服务费的 200% 在我方提交的投标保证金或采购人付给我方的中标合同款中扣付, 并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

【附件 12】 用户需求书响应表**用户需求书响应表**项目名称: GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目项目编号: HX12370115YLZC

条款序号	用户需求书条款	投标实际参数	响应情况	差异说明

【说明】1、投标人应对照招标文件中《用户需求书》的条款的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应技术需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2、投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求。

投标人法定代表人（或授权代表）签字：___

投标人名称（签章）：_____

日 期：____年____月____日

【附件 12-1】 设备配置清单

设备配置清单

(格式自定)

【备注】 投标人应提供详细的配置清单 (附相关有效的证明资料和产品宣传彩页)。

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 12-2】 设备的详细参数及简要说明书

设备的详细参数及简要说明书

(格式自定)

【备注】 投标人应提供产品详细技术参数及有效的图片资料。

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 13】同类项目业绩情况一览表

同类项目业绩情况一览表

项目名称: GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目

项目编号: HX12370115YLZC

序号	项目名称	采购人	联系人及电话	合同总价	签约日期

【说明】投标人应提供表列项目的合同复印件或用户使用报告的复印件。

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 14】 服务方案

服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容, 主要根据招标需求的要求 (格式自定)

1. 服务期限;
2. 应急响应时间安排;
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员 (包括厂商认证工程师等人员);
4. 制造商的技术支持;
5. 其它服务承诺;
6. 培训计划。

售后服务主要技术人员配置情况: (格式见附件 15)

供货商全省各地级市的产品维修电话和联系人: (格式自拟)

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 15】 服务技术人员一览表**服务技术人员一览表**项目名称: GE LISPEED VCT+LISPEED+CT (两台) 全保维修服务采购项目项目编号: HX12370115YLZC

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务

- 【备注】** 1. 投标人必须附上有关个人学历、工程师证、社保等证明文件 (复印件加盖公章)
2. 在使用地区配备稳定的服务人员, 须提供服务人员证明材料。

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: _____

投标人名称 (签章): _____

日 期: _____年____月____日

【附件 16】 通用合同书格式

合同编号: _____

合 同 书

项目名称: _____

合同编号: _____

签约地点: _____

签订日期: 二〇一六年 月 日

【备注】 本合同仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

CT 保修

甲 方: 广东省人民医院

地 址: 广州市中山二路 106 号

邮编: 510080

法定代表人: 庄建

电 话: 020-83818251

传 真: 020-83818251

乙 方:

地 址:

邮编:

法定代表人:

电 话:

传 真:

甲乙双方经过平等协商, 达成本合同 (以下简称“合同”)。合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

紧急人工和备件服务 (含开机保证) (LPU) 合同部分 (合同编号: _____):

1. 维修服务所保设备:

设备名称	GE 主机系统编号	装机日期	合同开始日期	合同终止日期	保养次数 (每年)
CT LISPEED VCT	82421160186	2005/7/18	2015/12/1	2018/11/30	4
CT LISPEED +	82421160177	2005/5/15	2015/12/1	2018/11/30	4
...					

附加设备系统/服务: 设备包含探测器及 AW4.2 工作站各 1 台。

乙方仅对以上列明的设备及附加设备系统/服务 (以下简称“设备”) 予以保修。

2. 乙方的责任:

- 乙方每年提供定期维护, 乙方工程师向甲方提供一份计划性的定期维护报告。乙方在预期保养时间之前一周内通知甲方保养时间, 如因甲

方原因导致不能执行保养,乙方原则上将不对此承担责任。如甲方确有合理原因导致不能执行保养,甲方可在预期保养时间之前一周内通知乙方并与乙方另行约定保养时间;如乙方确因甲方的时间调整而产生额外成本,乙方可要求甲方承担相关费用。原厂标准定期维护服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查,以及非紧急性质的预防性维护,并确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。此项定期维护服务间隔进行。

- 2) 乙方提供现场措施 (Field Action)。
- 3) 乙方为甲方提供在线支持、现场检修、零备件更换及高级保养耗材更换。
 - 3.1) 在线支持:协助甲方的工程师分析和维修有关设备。在甲方拨打维修热线后提供电话支援:800-8108188 维修热线,乙方资深工程师在线技术支持,答疑;乙方资深工程师即时诊断设备故障,制定维修方案。
 - 3.2) 现场检修:乙方在接到甲方报修电话后派遣工程师前往维修有关设备。工程师最多不超过两个工作日到达现场。原厂认证合格的专业工程师或原厂培训的特约维修队伍将提供快速优质的现场服务。
 - 3.3) 常用零备件更换:在合同有效期内,本合同服务范围内的设备进行约定维修所发生的费用(更换零部件费,乙方人工费和出差费等),由乙方承担。
 - 3.4) 高级保养耗材更换:在合同有效期内,本合同服务范围内的设备进行约定高级保养所发生的费用(更换高级保养耗材、乙方人工费和出差费等),由乙方承担。
- 4) 国内保税库零备件优先使用权:在合同有效期内,甲方如需更换零备件,可以具有优先使用乙方国内保税库的备件。乙方应在接到甲方的需求申请后,优先处理其诉求。
- 5) 开机保证:开机保证率承诺为 93%,计算公式如下:开机保证率=365天*93%,达不到开机保证率的情况下停机一天顺延一天。凡不在服务范围之内的系统部件损坏而导致停机,不包括在此条款之内。乙方工程师会配合保养计划,针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估,为设备潜在的问题提供预测性提示,以期减少设备非正常停机

的风险, 提高医疗设备的正常使用率, 帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务, 确保最佳投资的回报率。

6) 服务报告: 每次保养、维修后, 乙方工程师以邮件或 Email 或现场汇报的形式为甲方提供服务报告。

7) 远程数字化服务 (如果设备具有远程接入能力)

7.1) GE 数字化预知型客户服务是基于最新的数字化技术, 有别于传统的被动式的客户服务理念, 在宽带接入和智能化软件的基础上, 为客户提供不断强大的预知型主动式客户服务, 从而帮助医院有效提高设备使用效率, 确保投资回报率。

7.2) 甲方设备需具备宽带接入能力。

7.3) 远程维护: (1) 甲方提供接入设备的宽带设施, 或 (2) 乙方租赁给甲方接入设备的 ADSL 或 3G 设施, 每年提供肆次远程预防性保养。

7.4) 远程监测: (1) 甲方提供接入设备的宽带设施, 或 (2) 乙方租赁给甲方接入设备的 ADSL 或 3G 设施, 和乙方全球智能设备诊断系统连接, 为设备提供 24 小时远程检测。乙方有责任根据科技发展, 及时更新全球智能设备诊断系统, 提高监测灵敏度并扩大智能知识库。乙方亦会提供人工不定期远程监测服务。

7.5) 预知型故障报警: 乙方通过宽带设施, 在远程监测的基础上, 为设备提供预知型故障报警, 并进行故障远程服务。(本条款仅适用于 GE VCT、GE MR 3T/1.5T、GE Innova 系列)

7.6) 合同有效期内, 宽带连接通讯费由甲方承担。

8) 无限次 iLinq 技术应用在线支持

球管服务(TUI)合同部分(合同编号: _____):

1. 球管保用内容:

设备型号	GE 主机系统编号	CT 球管料号	年曝光量	合同开始日期	合同终止日期
CT LISPEED +	82421160177	D3185T	30 万秒次	2015/12/1	2018/11/30
/	/	/	/	/	/
设备型号	GE 主机系统编号	8M/Optima 660 球管料号	年病人量	合同开始日期	合同终止日期
CT LISPEED VCT	82421160186	D3193T	1.5 万人次	2015/12/1	2018/11/30
/	/	/	/	/	/

说明:

1.1) 在乙方提供合同约定服务前,乙方检查甲方原有球管的使用状况,并给出以下书面判断:乙方判断甲方原有 CT 球管尚可使用,则在合同期间甲方可继续使用甲方原有球管。如在合同期内,如甲方原有球管或乙方提供的球管发生损坏,甲方需将损坏的球管交付或返还给乙方,乙方重新提供给甲方可供使用的球管替代损坏的球管;在合同期间内球管使用权归甲方所有,乙方提供的球管或甲方交付给乙方的球管的产权归乙方所有。合同期满,甲乙双方同意甲方拥有正在使用的球管的使用权及产权。

乙方判断甲方原有 8M/Optima 660 球管尚可使用,则在合同期间甲方可继续使用甲方原有球管。如在合同期内,如甲方原有球管或乙方提供的球管发生损坏,甲方需将损坏的球管交付或返还给乙方,乙方重新提供给甲方可供使用的球管替代损坏的球管;在合同期间内球管使用权归甲方所有,乙方提供的球管或甲方交付给乙方的球管的产权归乙方所有。合同期满,甲乙双方同意甲方拥有正在使用的球管的使用权及产权。

1.2) 甲方应当在球管安装调试完毕后 7 日内将旧管套退还给乙方。如果因甲方原因导致旧管套无法退还,甲方须另行支付本合同价的 30%作为旧管套购买价。

1.3) 球管保用合同有效期

CT 球管保用合同有效期 2 年或 2 年以上。8M/Optima 660 球管保用合同有效期 3 年或 3 年以上。

2. 发货日期及条件:

在合同有效期内,如果球管出现无法使用的故障,经乙方工程师确认后,且甲方已付清本合同当期费用,并且 CT/8M/Optima 660 球管服务合同结算清超出+5%年曝光量/病人量的费用后,由乙方负责免费更换球管。发货时间为乙方确认后的两个工作日内。

3. 质量担保:

乙方保证按本合同提供的球管, 符合 GE 公司全球生产工艺方面的要求和产品在产地装运时的产品说明书和/或使用说明书中的质量标准, 没有任何材料和使用上的缺陷。

CT 球管服务(TUI)合同价款说明:

a) 球管保用合同计算价格= $\frac{\text{X}}{\text{X}}$

(球管保用合同计算价格=上一年总曝光量 X 单位曝光价格 X 合同有效年限(2 年以上) ;

b) 合同价格应以满足下列的条件为前提: 当年实际总曝光量应在上一年总曝光量的 $\pm 5\%$ 范围内。如果超过 $+5\%$, 应在合同年度付款时(最后一年在合同结束时)予以清算。

8M/Optima 660 球管服务(TUI)合同价款说明:

a) 球管保用合同计算价格= $[\frac{\text{元}}{\text{X}} + \frac{\text{X}}{\text{X}} (-6000)] \times \text{X}$

球管保用合同计算价格=[基础价格+每个病人价格 X (年病人量-6000 个病人)]X 合同有效年限 (3 年以上)。

b) 合同价格应以满足下列的条件为前提: 当年实际总病人量应在上一年总病人量的 $\pm 5\%$ 范围内。如果超过 $+5\%$, 应在合同年度付款时(最后一年在合同结束时)予以清算。